

Svenska

**iCare** PATIENT2



iCare PATIENT2  
Användarhandbok för iOS

**icare**

Rx Only (USA)

# Upphovsrätt

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående upplysning. Vid betydelskillnader i ett översatt dokument gäller den engelska versionen.

Denna apparat efterlever:

Förordningen om medicintekniska produkter (MDR) 2017/745

Användarhandboken gäller för version 1.1.x av iCare PATIENT2-programvaran, där x är en underhållsrevidering som inte påverkar användarhandboken.

Upphovsrätt © 2023 Icare Finland Oy. Med ensamrätt. iCare är ett registrerat varumärke för Icare Finland Oy. Alla övriga varumärken är egendom för respektive ägare. Tillverkad i Finland.

Android är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Google Inc. Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC. App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Icare Finland Oy sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.



**Icare Finland Oy**

Äyritie 22

01510 Vanda, Finland

Tel. +358 0 9775 1150

**[www.icare-world.com](http://www.icare-world.com), [info@icare-world.com](mailto:info@icare-world.com)**

**CE 0598**




# Innehåll


1. Avsedd användning.....	4
2. Säkerhetsinformation .....	4
3. Inledning.....	5
4. Systemkrav för iCare PATIENT2.....	6
5. Erhålla iCare-inloggningsuppgifter.....	6
6. Installera appen.....	7
7. Ansluta din mobilenhet till tonometern med Bluetooth®.....	7
7.1. Starta tonometern .....	7
7.2. Parkoppla tonometern med din mobilenhet .....	7
8. Överföra mätdata.....	8
9. Visa mätresultat .....	9
9.1. Graffunktion .....	9
9.2. Tabellfunktion.....	10
10. Ändra iCare PATIENT2-inställningar .....	11
11. Logga ut från iCare PATIENT2.....	11
12. Felsökning .....	12
13. Teknisk beskrivning.....	14
14. Symboler.....	15

# 1. Avsedd användning

iCare PATIENT2 (TS05) är en mobilapp som används för att överföra oftalmiska mätdata till iCare CLINIC eller externt system. Appen kan även visa oftalmiska mätdata och vara till hjälp i hanteringen av glaukom. Appen är avsedd både för vårdpersonal och lekmän.

## 2. Säkerhetsinformation

 **WARNING!** Se till att den mobilenhet där iCare PATIENT2 har installerats är inställd på korrekt datum och tid.


 **WARNING!** Innan du börjar mäta, ställ in tonometerens klocka på rätt tid på orten, antingen manuellt från tonometerens inställningar eller automatiskt genom att ansluta tonometeren till iCare PATIENT2-appen.

 **FÖRSIKTIGHET!** Allvariga incidenter relaterade till tonometeren ska rapporteras till behörig sjukvårdsmyndighet och till tillverkaren eller dennes representant.

### 3. Inledning

Programvarusystemet iCare består av följande:

- iCare HOME2-tonometer för mätning av ögontryck
- iCare PATIENT2-mobilappen med vilken patienter och vårdpersonal kan visa mätdata samt föra över och spara dem på iCare CLINIC eller iCare CLOUD-tjänsten
- iCare CLINIC, en webbläsartjänst med vilken vårdpersonal och patienter kan visa mätdata

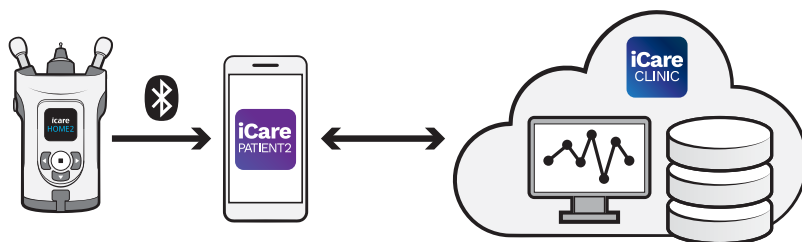

iCare CLOUD kan användas för att spara de resultat av ögontrycksmätningar som överförts från iCare HOME2 med iCare PATIENT2. Patienten kan spara sina mätdata på ett privat konto på tjänsten iCare CLOUD, om patientens tonometer inte är registrerad på en vårdgivares iCare CLINIC-konto.

För att visa mätresultat med PATIENT2-appen loggar du in med dina iCare-inloggningsuppgifter. För att se hur du får dina iCare-inloggningsuppgifter, se kapitel ”5. Erhålla iCare-inloggningsuppgifter”.

Dina inloggningsuppgifter skyddar mätresultaten så att ingen annan kommer åt dem. Om appen meddelar att inloggningsuppgifterna är ogiltiga betyder det att du har angett fel lösenord eller e-postadress, eller att ditt lösenord har blivit stulet. Lämna aldrig ut ditt lösenord till någon annan.

Om du är vårdpersonal kan du använda iCare PATIENT2 enbart för att överföra resultat av ögontrycksmätningar till iCare CLINIC. iCare PATIENT2 visar inte mätresultat med ett iCare CLINIC-yrkeskonto.

iCare PATIENT2 förväntas användas under olika föränderliga förhållanden som i hemmet och utomhus.

Applikationerna medför ingen oacceptabel kvarstående risk eller oönskade biverkningar och de har inga kontraindikationer.

För mer information om hur du använder HOME2, se användarhandboken för iCare HOME2.

## 4. Systemkrav för iCare PATIENT2

- iPhone eller iPad
- Operativsystem iOS 12 eller senare
- Internetuppkoppling

För att appen iCare PATIENT2 alltid ska fungera korrekt, installera de senaste programuppdateringarna för mobilenheten och appen iCare PATIENT2.

De senaste säkerhetskorrigeringarna för iCare PATIENT2 installeras med programvaruuppdateringarna. Uppdateringar distribueras via App Store.

## 5. Erhålla iCare-inloggningsuppgifter

För att visa mätresultat med appen iCare PATIENT2 loggar du in med dina iCare-inloggningsuppgifter. Om din iCare HOME2-tonometer är registrerad på klinikens eller sjukhusets CLINIC-konto ska du kontakta kliniken eller sjukhuset för att få tillgång till inloggningsuppgifter.

**Observera för vårdpersonal:** Inloggningsuppgifter för patienter kan skapas i iCare CLINIC under "Patient profile"-fliken (patientprofil) i sektionen "User account" (användarkonto), genom att ange patientens e-postadress. Patienten får en inbjudan via e-post med en länk för att skapa lösenord.

Om tonometern inte är registrerad på ett CLINIC-konto för klinik eller sjukhus måste du registrera tonometern på iCare CLOUD för att kunna använda iCare PATIENT2-appen. För anvisningar om att registrera tonometern, läs "Kom igång"-guiden som medföljer din tonometer iCare HOME2. Du får inloggningsuppgifter till iCare under registreringens gång.

Om du behöver hjälp, kontakta vårdpersonal, tonometerns återförsäljare eller iCare.

**OBS!** Inloggningsuppgifter för yrkesanvändare (läkare, utbildare eller administratörer) till iCare CLINIC kan inte användas för att logga in på PATIENT2-appen. PATIENT2-appen används endast för att visa en patients resultat med patientens egna CLINIC-inloggningsuppgifter. Appen används också för att ladda upp mätdata från iCare HOME2(s) till iCare CLINIC, för vilket inloggning på PATIENT2 inte krävs.

## 6. Installera appen

1. Öppna App Store på din mobilenhet.
2. Sök på iCare PATIENT2.
3. Följ de anvisningar för installation som visas på skärmen.








## 7. Ansluta din mobilenhet till tonometern med Bluetooth®

### 7.1. Starta tonometern

**OBS!** Bluetooth-anslutningen är endast kompatibel med iCare HOME2-tonometern.

**OBS!** iCare HOME är enbart kompatibelt med mobila Android-enheter.

Bluetooth är kanske redan aktiverat på tonometern. Du kan kontrollera tonometerens Bluetooth-status och starta Bluetooth vid behov genom att följa dessa instruktioner.

1. Tryck på  tills du hör ett pip ljud för att starta tonometern.
2. Tryck på  tills du ser **SETTINGS** (INSTÄLLNINGAR) på tonometerens skärm, och tryck på .
3. Tryck på  tills du ser **BLUETOOTH**, och tryck på .
4. Om Bluetooth är av, tryck på  tills du ser **TURN ON** (SLÅ PÅ) och tryck på .

### 7.2. Parkoppla tonometern med din mobilenhet

1. Gå till mobilenhetens inställningar och starta Bluetoothfunktionen.
2. Öppna iCare PATIENT2-appen och tryck på **START USING THE APP** (BÖRJA ANVÄNDA APPEN).

3. Välj ditt land och var ögontrycksdata ska sparas.
4. Läs och godkänn användarvillkoren och godkänn behandling av personuppgifter genom att markera respektive rutor.
5. Tryck på **CONTINUE** (FORTSÄTT).
6. Tryck på **SCAN DEVICES** (SÖK EFTER ENHETER). Om appen ber om tillstånd att använda Bluetooth, tryck på **OK**.
7. Välj rätt tonometer från listan av detekterade iCare HOME2-tonometrar. Kontrollera att serienumret på mobilens skärm matchar numret som finns på tonometerns baksida. Serienumret på din tonometer är markerat med SN.



8. Tryck på **PAIR TONOMETER** (PARKOPPLA TONOMETER).
9. När begäran om Bluetooth-koppling visas, ange den PIN-kod som visas på tonometerns skärm och tryck på **Pair** (Parkoppla).
10. När tonometern har parkopplats med mobilen, tryck på **CONTINUE** (FORTSÄTT) på PATIENT2.

Du kan nu trycka på **SYNC** (SYNKA) för att överföra mätresultat från tonometern till iCare CLINIC eller iCare CLOUD, eller logga in på iCare PATIENT2-appen för att visa tidigare mätresultat.

## 8. Överföra mätdata

1. Starta tonometern.
2. Öppna appen iCare PATIENT2 på din mobilenhet.
3. Tryck på **SYNC** (SYNKA) för att överföra mätningar från tonometern till mobilenheten.
4. Om ett popupfönster som begär dina iCare-uppgifter öppnas ska du skriva in ditt användarnamn och lösenord eller säkerhetskoden från din vårdgivare.



Överföringen kan ta upp till ett par minuter beroende på nätverksanslutningen. Meddelandet "[number of] measurements transferred" ([antal] överförda mätningar) eller "no new measurements" (inga nya mätningar) visas när alla data har överförts.



Mätresultat raderas från tonometersns minne efter att de har lagrats i molnet.

## 9. Visa mätresultat

### 9.1. Graffunktion

1. Öppna appen iCare PATIENT2 på din mobilenhet.
2. Om du inte är inloggad, tryck på **LOGIN** (LOGGA IN) och ange dina iCare-inloggningsuppgifter. För information om hur du får tillgång till iCare-inloggningsuppgifter, se kapitel "5. Erhålla iCare-inloggningsuppgifter".
3. Tryck på **MEASUREMENTS** (MÄTNINGAR).

Den blå grafen visar mätningar av höger öga och den orange grafen visar mätningar av vänster öga. Grafen kan visas i stående eller liggande läge.

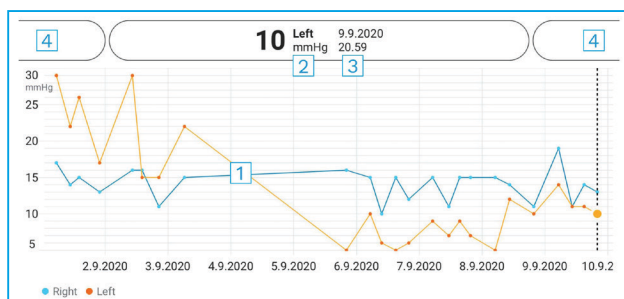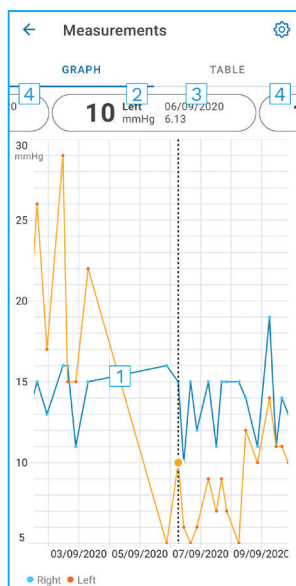

- 1: Markerat mätvärde i diagrammet
- 2: Den markerade mätningens resultat i mmHg
- 3: Datum och tid för mätningen
- 4: Tryck för att öppna föregående eller nästa mätning


Förflytta dig på diagrammet genom att dra fingret över skärmen.

Zooma in och ut på diagrammet genom att hålla två fingrar på pekskärmen och dra isär eller föra ihop dem vågrätt.



För att se resultat för varje mätning, tryck på punkterna på grafen. Du kan även bläddra med fingret på ett mätresultat för att visa nästa eller föregående resultat.

Om en mätning är markerad med , betyder det att mätvärdet ligger utanför den valda skalan. Tryck på  för att se mätresultatet.
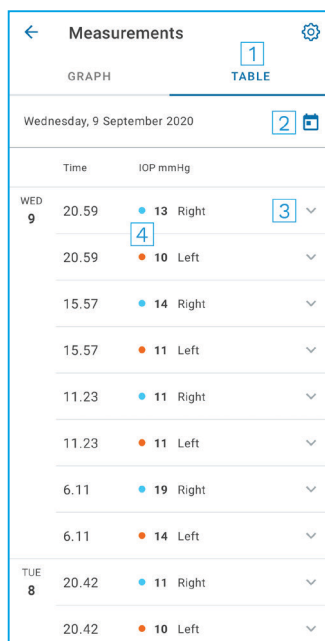
## 9.2. Tabellfunktion




Time	IOP mmHg
20.59	● 13 Right
20.59	● 10 Left
15.57	● 14 Right
15.57	● 11 Left
11.23	● 11 Right
11.23	● 11 Left
6.11	● 19 Right
6.11	● 14 Left
20.42	● 11 Right
20.42	● 10 Left

- 1: Tryck på **Table** (Tabell) för att visa mätningar i listformat
- 2: Välj datum från 
- 3: Tryck på  för att visa mätkvaliteten
- 4: Den blå punkten visar mätningen av höger öga och den orange punkten visar mätningen av vänster öga

Förflytta dig i listan genom att dra fingret vertikalt över skärmen.

## 10. Ändra iCare PATIENT2-inställningar

På hemskärmen, tryck på  > **Settings** (Inställningar).

För att definiera vilka värden som ska visas i diagrammet, tryck på **Max value in graph** (Maximivärde i graf) eller **Min value in graph** (Minimivärde i graf) och välj ett nytt värde.

Om du vill använda en annan tonometer med appen, tryck på **Change the tonometer** (Byt tonometer). Du loggas automatiskt ut från appen.

## 11. Logga ut från iCare PATIENT2

Du behöver inte logga ut från appen när du använder den i vardagen.

Om du är mån om din integritet ska du logga ut från appen för att andra personer inte ska kunna se dina mätresultat.

På hemskärmen, tryck på  > **Settings** (Inställningar) > **Logout** (Logga ut).

Efter att du har loggat ut kan du fortfarande föra över mätningar från tonometern **till iCare CLINIC eller iCare CLOUD**, men du kan inte längre visa dem på mobilenheten.

Du kan avinstallera appen iCare PATIENT2 om du inte behöver använda den mer. Data från ögontrycksmätningar raderas inte från iCare CLINIC eller iCare CLOUD bara för att du avinstallerar appen.

## 12. Felsökning

**Tips:** För kontaktuppgifter, till exempel e-postadresser till iCare, tryck på  > **Info**.

<b>Problem</b>	<b>Möjlig förklaring och lösning</b>
Du får felmeddelandet <b>Cannot scan for devices</b> (Hittar inga enheter).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aktivera Bluetooth-anslutningen på din mobilenhet.</li><li>2. Ge iCare PATIENT2 tillstånd att använda Bluetooth på mobilenheten: gå till <b>Inställningar</b> på din mobila enhet &gt; <b>iCare PATIENT2</b>, och aktivera Bluetooth.</li></ol>
Du får felmeddelandet <b>Error during pairing</b> (Fel vid parkoppling).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollera att din mobilenhet är ansluten till internet.</li><li>2. Parkoppla tonometern till mobilenheten igen och se till att du anger rätt PIN-kod vid Bluetooth-parkopplingen.</li><li>3. Kontrollera att du har startat tonometern och att Bluetooth-anslutningen är aktiv både på tonometern och på mobilen.</li><li>4. Kontrollera att du har aktiverat tillstånd för Bluetooth på mobilenheten.</li></ol>
Du har överfört mätresultat från tonometern men kan inte se dem i dina mätresultat.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se till att tonometern är registrerad under ert namn. Kontakta vårdpersonal, tonometerns återförsäljare eller iCare.</li><li>2. Kontrollera även att tonometerns klocka visar rätt tid. Om den inte gör det, för över mätdata en gång från tonometern till mobilenheten. Tonometerns klocka uppdateras under överföringen.</li></ol>
Du får felmeddelandet <b>Error while reading measurements from tonometer (Fel när mätningar skulle läsas från tonometern)</b> .	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se till att du har startat tonometern och att Bluetooth-anslutningen är aktiv både på tonometern och på den mobila enheten.</li><li>2. Se till att du har gett iCare PATIENT2 tillstånd att använda Bluetooth på din mobila enhet: gå in på Inställningar på din mobila enhet &gt; iCare PATIENT2 och aktivera Bluetooth.</li></ol>
Du får felmeddelandet <b>Error while sending measurements to CLINIC</b> (Ett fel uppstod när mätningar skulle skickas till CLINIC).	Kontrollera att din mobilenhet är ansluten till internet.

Problem	Möjlig förklaring och lösning
Du får felmeddelandet <b>Connection error to server (Anslutningsfel till servern). Det går inte att läsa in mätvärdena.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera att din mobilenhet är ansluten till internet.</li> <li>2. Stäng mättningsfönstret och öppna det igen. Felmeddelandet visas även om du loggar in på appen iCare PATIENT2 med CLINIC-användaruppgifter för vårdpersonal istället för patient.</li> </ol>
Du får felmeddelandet <b>User is not authorized (Obehörig användare). Det går inte att läsa in mätvärdena.</b>	Din inloggningssession har löpt ut. Logga in igen.
Du får felmeddelandet <b>Tonometer has not been registered</b> (Tonometern är inte registrerad).	Din tonometer måste registreras. Se kapitel ”5. Erhålla iCare-inloggningssuppgifter” för information om hur du registrerar din tonometer.
Du får felmeddelandet <b>Login failed due to an unexpected error (Inloggningen misslyckades på grund av ett oväntat fel).</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera att din mobilenhet är ansluten till internet.</li> <li>2. Försök logga in på iCare PATIENT2-appen igen.</li> </ol> <p>Om problemet kvarstår, kontakta vårdpersonal, tonometerns återförsäljare eller iCare.</p>
Du får felmeddelandet <b>Invalid credentials (Ogiltiga inloggningsuppgifter). Kontrollera säkerhetskoden och försök igen.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se till att din säkerhetskod stämmer. Be om säkerhetskoden från din vårdgivare.</li> <li>2. Försök skicka mätresultaten igen.</li> </ol> <p>Kontakta <a href="mailto:home-software-support@icare-world.com">home-software-support@icare-world.com</a> om problemet kvarstår.</p>
Du får felmeddelandet <b>Device license has expired</b> (Enhetslicensen har gått ut).	Be din sjukvårds- eller tjänsteleverantör att förnya licensen.
Du behöver hjälp med iCare PATIENT2-appen.	Kontakta vårdpersonal, tonometerns återförsäljare eller iCare.

Om iCare PATIENT2-appen inte fungerar som den ska eller om du upptäcker fel i den här användarhandboken, kontakta **info@icare-world.com**, eller **infoUSA@icare-world.com** om du befinner dig i USA.

## 13. Teknisk beskrivning

När iCare HOME2-tonometern ansluts till en mobilenhet med Bluetooth läser iCare PATIENT2-appen tonometerens resultat från ögontrycksmätningar. Appen för också över och lagrar resultaten till iCare CLINIC- eller iCare CLOUD-databasen, med hjälp av mobilenhetens uppkoppling. Appen använder även uppkopplingen för att läsa mätresultat från databasen, eftersom resultaten endast sparas i databasen och inte på mobilenheten.

En mobilenhet som iCare PATIENT2-appen är installerad på ska inte kopplas upp till IT-nätverk som vårdpersonalens medicintekniska produkter eller program är uppkopplade till.




En mobilenhet med appen iCare PATIENT2 installerad kan använda alla internetuppkopplingar som tillåter HTTPS-kommunikation.

Vid fel på internetuppkopplingen kan mätresultaten inte överföras från iCare HOME2-tonometern till databasen iCare CLINIC, och mätresultaten kan inte heller visas.

Resultat av ögontrycksmätningar visas i millimeter kvicksilver (mmHg) med en millimeter kvicksilvers noggrannhet. Y-skalan går från 5 till 50 mmHg.

Den huvudsakliga IT-säkerhetsrisken kopplad till iCare PATIENT2 är relaterad till skadlig programvara och din mobila enhets viruskydd. Se till att din mobila enhets skydd mot virus och skadlig programvara är uppdaterat.

## 14. Symboler

	Tillverkare
	Försiktighet
<b>Rx Only (USA)</b>	Enligt federal lagstiftning i USA får försäljning av detta instrument endast ske genom eller på ordination av läkare eller person med erforderligt tillstånd.
<b>CE</b>	CE-märke
	Produkten är en medicinteknisk produkt



## Icare Finland Oy

Äyritie 22  
01510 Vanda, Finland  
Tel. +358 0 9775 1150  
info@icare-world.com

## Icare USA, Inc.

4700 Falls of Neuse Rd. Ste 245  
Raleigh, NC. 27609  
Tel. +1 888.422.7313  
Fax +1 877.477.5485  
infoUSA@icare-world.com

[www.icare-world.com](http://www.icare-world.com)

# icare

Icare är ett registrerat varumärke som tillhör Icare Finland Oy, Centervue S.p.A., Icare Finland Oy, och Icare USA Inc. är delar av Revenio Group och representerar varumärket iCare. Inte alla produkter, tjänster eller erbjudanden som hänvisas till i denna broschyr har godkänts eller finns att tillgå på alla marknader, och godkänd märkning och instruktioner kan variera från land till land. Produktspecifikationer kan komma att förändras i och med justeringar i produktdesign och tillämpningsområde och som resultat av löpande teknisk utveckling.